JQA


計測器の校正
認定品目・範囲

JQAはISO/IEC 17025に基づき
IAJapan（JCSS）、A2LAから認定された校正機関です

2026年8月改訂版

表のみかた

『計測器の校正　認定品目・範囲』は、JQA で認定校正が可能な計測器とその範囲等をご紹介する冊子です。
以下に表のみかたをご案内いたします。校正に関する費用・納期等の詳細につきましては、裏表紙に記載の最寄りの「お問い合わせ先」までお気軽にご連絡ください。

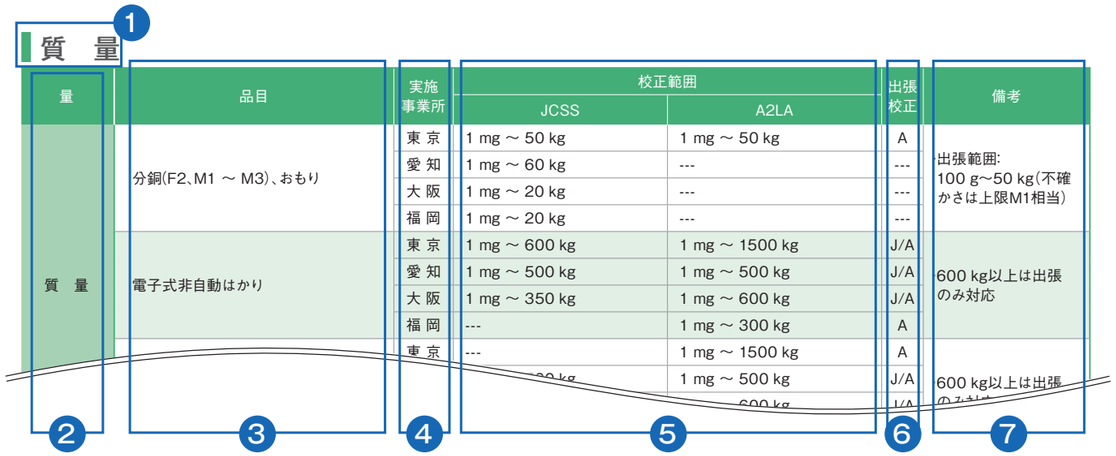

❶分野

校正の分野です。右ページの目次に対応しています。

❷量

校正の対象となる量です。

❸品目

校正が可能な計測器名です。

❹実施事業所

校正の実施事業所※です。
●「東 京」: 計量計測センター（東京都八王子市）
●「愛 知」: 中部試験センター（愛知県北名古屋市）
●「大 阪」: 関西試験センター（大阪府東大阪市）
●「福 岡」: 九州試験所（福岡県久留米市）
※最寄りの事業所でご希望の校正を実施していない場合は、他の事業所にて対応いたします。

❺校正範囲

JCSS または A2LA にて校正が可能な範囲・校正の可否を記載しています。
●「 ○ 」: 校正可能です。校正範囲は裏表紙に記載の最寄りの「お問い合わせ先」までご連絡ください。
●「 --- 」: 校正不可です。

❻出張校正

出張校正の可否を記載しています。
●「 J 」: 出張校正可能です。(JCSS)
●「 A 」: 出張校正可能です。(A2LA)
●「J/A」: 出張校正可能です。(JCSS および A2LA)
●「 --- 」: 出張校正不可です。

❼備考

校正条件等に関する特記事項を記載しています。

認定機関のシンボルは、JQA が発行する校正証明書に表示されます

ilac-MRA　IAJapan Accredited Calibration　JCSS
JCSS 0029
JCSS 0064
JCSS 0071
JCSS 0104

このシンボルは、国際MRA対応JCSS認定事業者であることを示すものです。JQA計量計測センター（JCSS 0029）、中部試験センター（JCSS 0064）、関西試験センター（JCSS 0071）および九州試験所（JCSS 0104）は、国際MRA対応JCSS認定事業者です。

ilac-MRA　A2LA ACCREDITED
CERTIFICATE #s
1400.01/03/04/05

このシンボルは、米国試験所認定協会（A2LA）から認定された校正機関であることを示すものです。JQA 計量計測センター（1400.01）、中部試験センター（1400.04）、関西試験センター（1400.03）および九州試験所（1400.05）は、ISO/IEC 17025に基づきA2LAから認定された校正機関です。

計測器の校正　認定品目・範囲

目　次

2026年8月改訂版

長　さ 04
放射線 08
電気(直流・低周波) 08
電気(高周波) 10
光 11
回転速度 12
時　間 13
EMC機器 13
温　度 14
湿　度 15
質　量 15
力 16
トルク 17
硬　さ 17
圧　力 18
流速・流量 20
音響・振動 20
濃　度 21
粘　度 22
微粒子 22
熱　量 22
密　度 22
体　積 23
衝突エネルギー 23

長　さ

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
レーザ波長	波長安定化He-Ne レーザ	東 京	633 nm領域	633 nm領域	---	
長　さ	【標準器】					
	ブロックゲージ （光波干渉測定による校正）	東 京	0.1 mm ～ 1000 mm	0.1 mm ～ 1000 mm	---	
	ブロックゲージ （比較測定による校正）	東 京	0.1 mm ～ 1000 mm	0.1 mm ～ 1000 mm	---	
		愛 知	0.5 mm ～ 500 mm	0.5 mm ～ 500 mm	---	
		大 阪	0.5 mm ～ 500 mm	0.1 mm ～ 500 mm	---	
	標準尺	東 京	1000 mm以下	1000 mm以下	---	
		大 阪	---	500 mm以下	---	
	パターン	大 阪	---	300 mm以下	---	
	一次元回折格子（マイクロスケール）	東 京	97 nm ～ 1000 nm	---	---	
	【ゲージ類・校正用マスタ類】					
	リングゲージ	東 京	---	0.1 mm ～ 250 mm	---	
		愛 知	---	1 mm ～ 200 mm	---	
		大 阪	---	0.1 mm～150 mm		
		福 岡	---	1 mm ～ 100 mm	---	
	テーパリングゲージ	大 阪	---	2.6 mm ～ 150 mm	---	
	ねじリングゲージ	大 阪	---	2.6 mm ～ 150 mm	---	
	テーパねじリングゲージ	大 阪	---	2.6 mm ～ 150 mm	---	
	ピンゲージ	東 京	---	0.1 mm ～ 250 mm	---	
		愛 知	---	0.3 mm ～ 100 mm	---	
		大 阪	---	0.1 mm ～ 100 mm	---	
	プラグゲージ	東 京	---	1 mm ～ 250 mm	---	
		愛 知	---	1 mm ～ 100 mm	---	
		大 阪	---	1 mm ～ 100 mm	---	
	テーパプラグゲージ	大 阪	---	1 mm ～ 100 mm	---	
	ねじプラグゲージ	東 京	---	有効径：120 mm以下 外径：120 mm以下	---	
		愛 知	---	有効径：30 mm以下 外径：30 mm以下	---	
		大 阪	---	有効径：150 mm以下 外径：150 mm以下	---	
	テーパねじプラグゲージ	大 阪	---	150 mm以下	---	
	ねじ測定用三針	東 京	---	6 mm以下	---	
		大 阪	---	5.05 mm以下	---	
	基準棒	東 京	600 mm以下	1000 mm以下	---	
		愛 知	1000 mm以下	1000 mm以下	---	
		大 阪	500 mm以下	1000 mm以下	---	
		福 岡	---	500 mm以下	---	
	ステップハイトゲージ	東 京	---	0.02 μm ～ 1000 μm	---	
	ステップゲージ （光波干渉測定による校正）	東 京	---	1010 mm以下	---	・チェックマスタ、内側マイクロチェッカのみ校正可能 ・詳細は要お問い合わせ
	ステップゲージ （比較測定による校正）	東 京	1010 mm以下	1050 mm以下	---	
		愛 知	670 mm以下	1000 mm以下	---	
		大 阪	670 mm以下	1000 mm以下	---	
	ダイヤルゲージ校正器	東 京	---	100 mm以下	---	
		愛 知	25 mm以下	---	---	
		大 阪	100 mm以下	25 mm以下	---	
	すきまゲージ	東 京	---	0.01 mm ～ 3 mm	---	
		愛 知	---	0.01 mm ～ 3 mm	---	
		大 阪	---	0.01 mm ～ 3 mm	---	
	はさみゲージ	大 阪	---	150 mm以下	---	
	テストバー	大 阪	---	100 mm以下	---	
	【精密測定機】					
	万能測長機	東 京	---	1000 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	---	100 mm以下	A	
		大 阪	---	3000 mm以下	A	

※表のみかたはP02でご案内しています。

長　さ

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
長　さ	測定顕微鏡	東 京	---	300 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	---	300 mm以下	A	
		大 阪	---	300 mm以下	A	
		福 岡	---	200 mm以下	A	
	マイクロスコープ	大 阪	---	10 mm以下	---	
	測定投影機	東 京	---	600 mm以下	A	・スクリーンの直径 ・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	---	600 mm以下	A	
		大 阪	---	600 mm以下	A	
		福 岡	---	600 mm以下	A	
	三次元測定機	東 京	---	1510 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	---	1000 mm以下	A	
		大 阪	---	1000 mm以下	A	
		福 岡	---	1000 mm以下	A	
	非接触三次元測定機	東 京	---	300 mm以下	A	
	レイアウトマシーン	東 京	---	3000 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
		大 阪	---	3000 mm以下	A	
	触針式表面粗さ測定機	東 京	---	Ra≦3 μm Rz≦10 μm	A	・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	---	Ra≦3 μm Rz≦10 μm	A	
		大 阪	---	Ra≦3 μm Rz≦10 μm	A	
	粗さ標準片	東 京	---	Ra≦5 μm Rz≦20 μm	---	
	段差標準片	東 京	---	深さ：21 μm以下 段差：500 μm以下	---	
	3Dスキャナ	大 阪	---	2000 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
	画像寸法測定器	大 阪	---	340 mm以下	A	・IM、LMシリーズのみ校正可能 ・詳細は要お問い合わせ
	電気マイクロメータ	東 京	---	3 mm以下	---	
		愛 知	---	5 mm以下	---	
		大 阪	---	5 mm以下	---	
	指針測微器	東 京	---	100 μm以下	---	
		大 阪	---	100 μm以下	A	
	ダイヤルリニアゲージ	東 京	---	100 mm以下	A	
	デジタルインジケータ	東 京	---	100 mm以下	A	
		愛 知	100 mm以下	100 mm以下	A	
		大 阪	---	100 mm以下	A	
		福 岡	---	100 mm以下	A	
	デジタルインジケータゲージ （JIS B 7563:2021による校正）	東 京	---	100 mm以下	---	・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	100 mm以下	100 mm以下	---	
		大 阪	---	100 mm以下	---	
	デジタルリニアハイト（マイクロハイト）	東 京	---	900 mm以下	A	
		愛 知	600 mm以下	600 mm以下	A	
		大 阪	---	1000 mm以下	A	
		福 岡	---	1000 mm以下	A	
	レーザスキャンマイクロメータ	東 京	---	50 mm以下	---	
	レーザ変位計	東 京	---	750 mm以下	---	・詳細は要お問い合わせ
	シャフト形状測定機	東 京	---	外径：230 mm以下 寸法：420 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
	真円度測定機	大 阪	---	拡大倍率の相対誤差： 500 μm以下 回転精度（半径方向、軸方向）： 500 μm以下 真直度精度：140 mm以下 平行度：280 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
	膜厚計	東 京	---	1520 μm以下	---	・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	---	1550 μm以下	---	

※表のみかたはP02でご案内しています。

長　さ

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
長　さ	輪郭形状測定機	大 阪	---	200 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
	【測定工具】					
	ノギス	東 京	---	2000 mm以下	A	
		愛 知	1000 mm以下	1000 mm以下	A	
		大 阪	600 mm以下	2000 mm以下	A	
		福 岡	1000 mm以下	1000 mm以下	A	
	穴ピッチノギス	東 京	---	1000 mm以下	A	
		愛 知	---	1000 mm以下	A	
	ハイトゲージ	東 京	---	600 mm以下	A	
		愛 知	600 mm以下	600 mm以下	A	
		大 阪	600 mm以下	1000 mm以下	A	
		福 岡	1000 mm以下	1000 mm以下	A	
	外側マイクロメータ	東 京	---	1000 mm以下	A	
		愛 知	500 mm以下	500 mm以下	A	
		大 阪	500 mm以下	1000 mm以下	A	
		福 岡	500 mm以下	1000 mm以下	A	
	スナップゲージ(指示マイクロメータ)	東 京	---	200 mm以下	A	
	三点式内側マイクロメータ（ホールテスト）	東 京	---	2 mm ～ 200 mm	A	
		愛 知	---	2 mm ～ 200 mm	A	
		大 阪	---	2 mm ～ 150 mm	A	
	キャリパ形内側マイクロメータ	東 京	---	300 mm以下	A	
		愛 知	---	500 mm以下	A	
		大 阪	---	500 mm以下	A	
		福 岡	---	500 mm以下	A	
	棒形内側マイクロメータ(単体形)	東 京	---	1000 mm以下	A	
		愛 知	---	500 mm以下	A	
		大 阪	500 mm以下	1000 mm以下	A	
		福 岡	500 mm以下	1000 mm以下	A	
	デプスマイクロメータ	東 京	---	300 mm以下	A	
		愛 知	---	300 mm以下	A	
		大 阪	---	500 mm以下	A	
		福 岡	---	300 mm以下	A	
	マイクロメータヘッド	東 京	---	50 mm以下	---	
		大 阪	---	50 mm以下	---	
	シリンダゲージ	東 京	---	1.6 mm以下	A	
		愛 知	1.6 mm以下	1.6 mm以下	A	
		大 阪	---	1.2 mm以下	A	
		福 岡	---	1.6 mm以下	A	
	ダイヤルゲージ	東 京	---	100 mm以下	A	
		愛 知	100 mm以下	100 mm以下	A	
		大 阪	10 mm以下	100 mm以下	A	
		福 岡	---	100 mm以下	A	
	てこ式ダイヤルゲージ	東 京	---	1.6 mm以下	A	
		愛 知	1.6 mm以下	1.6 mm以下	A	
		大 阪	1.6 mm以下	1.6 mm以下	A	
		福 岡	---	1.6 mm以下	A	
	ダイヤルキャリパゲージ	東 京	---	100 mm以下	A	
		愛 知	---	200 mm以下	A	
		大 阪	---	200 mm以下	A	
		福 岡	---	200 mm以下	A	
	シックネスゲージ	東 京	---	100 mm以下	A	
		愛 知	---	50 mm以下	A	
		大 阪	---	50 mm以下	A	
		福 岡	---	50 mm以下	A	

※表のみかたはP02でご案内しています。

長　さ

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
長　さ	デプスゲージ	東 京	---	600 mm以下	A	
		愛 知	300 mm以下	300 mm以下	A	
		大 阪	300 mm以下	1000 mm以下	A	
		福 岡	---	600 mm以下	A	
	ダイヤルデプスゲージ	東 京	---	100 mm以下	A	
		愛 知	---	12 mm以下	A	
		大 阪	---	200 mm以下	A	
	Rゲージ	大 阪	---	150 mm以下	---	
	枠ゲージ	大 阪	---	200 mm以下	---	
	試験用ふるい	大 阪	---	目開き：125 mm以下 線径：8 mm以下	---	
	口元径測定器	大 阪	---	40 mm以下	---	
	CRノギス	大 阪	---	25 mm以下	A	
	C面ノギス	大 阪	---	15 mm以下	A	
	【直尺・巻尺類】					
	直尺(旧基準器相当)	愛 知	5 m以下	5 m以下	---	
	金属製直尺(端面基点)	愛 知	3 m以下	3 m以下	---	
	鋼製巻尺	愛 知	100 m以下	100 m以下	---	
	繊維製巻尺(グラスファイバー製)	愛 知	---	100 m以下	---	
	水位計	愛 知	---	100 m以下	---	
	タンクスケール	愛 知	---	100 m以下	---	
	コンベックスルール	愛 知	---	15 m以下	---	
	直径測定用巻尺(バイテープ)	愛 知	---	直径：1800 mm以下	---	
	ワイヤ変位計	愛 知	---	5 m以下	---	
	【光学素子】					
	オプチカルフラット	東 京	---	150 mm以下	---	
	オプチカルパラレル	東 京	---	30 mm以下	---	
	【一軸試験機・硬さ関連機器】					
	伸び計校正器	東 京	100 mm以下	100 mm以下	---	
		大 阪	100 mm以下	---	---	
	伸び計(JIS B 7741による校正)	東 京	600 mm以下	600 mm以下	J/A	・大阪は出張のみ対応 ・詳細は要お問い合わせ
		大 阪	600 mm以下	---	J	
	伸び計(ASTM E83による校正)	東 京	---	600 mm以下	A	・大阪は出張のみ対応 ・詳細は要お問い合わせ
		大 阪	---	600 mm以下	A	
	インデックスマスタ	東 京	---	260 μm以下	---	
		大 阪	---	250 μm以下	---	
	ブリネル硬度計圧痕測定用ゲージ	東 京	10 mm以下	10 mm以下	---	
		大 阪	---	10 mm以下	---	
角　度	ロータリエンコーダ	東 京	0° ～ 360°	---	---	
	オートコリメータ	東 京	---	±10'	---	
	水準器	東 京	---	±2'	---	
		愛 知	---	±1°	---	
		大 阪	---	±2.5 mm/m	---	
	多面鏡	東 京	---	0° ～ 360°	---	
	回転台	東 京	---	0° ～ 1800°	---	
	角度計	東 京	---	0° ～ 360°	---	
		愛 知	---	0° ～ 360°	---	
	角度ゲージ	東 京	---	0° ～ 360°	---	
	プロトラクタ	東 京	---	0° ～ 360°	---	
		大 阪	---	0° ～ 360°	---	
	精密定盤	東 京	---	2000 mm × 1500 mm以下	A	・詳細は要お問い合わせ
		愛 知	---	2000 mm × 2000 mm以下	A	
		大 阪	---	2000 mm × 1500 mm以下	A	
		福 岡	---	2000 mm × 1500 mm以下	A	
	直角定規	東 京	---	700 mm以下	---	

※表のみかたはP02でご案内しています。

長　さ

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
角　度	円筒スコヤ	東 京	---	700 mm以下	---	
	直定規	東 京	---	1500 mm以下	A	
形状測定	形状測定	東 京	---	寸法：1000 mm以下 角度：360° 以下	---	・詳細は要お問い合わせ
		大 阪	---	寸法：300 mm以下 角度：180° 以下	---	
	幾何偏差	大 阪	---	真円度、同軸度、同心度、振れ：500 μm以下 平面度、真直度、直角度、 平行度、円筒度：140 mm以下	---	・詳細は要お問い合わせ

放射線

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
放射線	X線測定器	東 京	10 keV ～ 200 keV	---	---	
	γ線測定器	東 京	662 keV（Cs-137）	---	---	
	表面汚染用サーベイメータ	東 京	機器効率：Am-241 α線， Cl-36 β線	---	---	
	放射線用電荷測定器	東 京	±5nC～±100nC	---	---	

電気（直流・低周波）

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
直流・低周波	デジタルマルチメータ	東 京	○	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	周波数カウンタ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	クランプメータ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	温度記録計、温度計	東 京	---	○	A	
		愛 知	○	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	標準電圧電流発生器	東 京	○	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	電源 （直流安定化電源・交流安定化電源）	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	単相電力計	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	

※表のみかたはP02でご案内しています。

電気（直流・低周波）

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
直流・低周波	力率（位相）計	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	三相電力計	東 京	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	回転計、ストロボスコープ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	高電圧計	東 京	---	○	---	
		愛 知	---	○	---	
		大 阪	---	○	---	
		福 岡	---	○	A	
	絶縁抵抗計、高抵抗計	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	耐圧試験器・絶縁耐圧試験器	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	アース導通テスタ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	標準抵抗器	東 京	○	○	---	
		大 阪	---	○	A	
	可変抵抗器	東 京	○	○	---	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	高抵抗器	東 京	○	○	---	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	デジタル抵抗測定器	東 京	○	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	抵抗ブリッジ	東 京	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	標準コンデンサ	東 京	---	○	---	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	容量測定器	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	標準インダクタ	東 京	---	○	---	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	誘導測定器	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	LCR測定器	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	

電気（直流・低周波）

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
直流・低周波	オシロスコープ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	電圧プローブ、電流プローブ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	変調度計	大 阪	---	○	A	
	ひずみ率計校正器	東 京	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	オーディオアナライザ、ひずみ率計	東 京	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	ストレイン測定器	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	ストレイン校正器	東 京	---	○	---	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	---	

電気（高周波）

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
高周波	信号発生器校正装置	東 京	---	○	---	
		大 阪	---	○	---	
	信号発生器	東 京	○	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	パルス発生器	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	任意波形発生器（ファンクションジェネレータ）	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	オシロスコープ校正器	東 京	---	○	---	
		愛 知	---	○	---	
		大 阪	---	○	---	
	50Ω系マイクロ波電力計、電力測定用マウント	東 京	○	○	---	
		大 阪	○	○	---	
	高周波電力計	東 京	○	○	---	
		大 阪	○	○	---	
	50Ω系減衰器	東 京	○	○	---	
	50Ω系減衰器、方向性結合器（結合度・方向性）	東 京	○	○	---	
		大 阪	○	○	---	
	75Ω系減衰器、方向性結合器（結合度・方向性）	東 京	---	○	---	
	不平衡形600Ω系減衰器	東 京	---	○	---	
		大 阪	---	○	---	
	平衡形75Ω・600Ω系減衰器	東 京	---	○	---	
		大 阪	---	○	---	
	減衰器	東 京	---	○	---	
		大 阪	---	○	A	

※表のみかたはP02でご案内しています。

電気（高周波）

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
高周波	50Ω系アンプ、50Ω系フィルタ	大 阪	---	○	---	
	減衰器校正装置	東 京	○	○	---	
		大 阪	○	○	---	
	インピーダンス素子	東 京	○	○	---	
		大 阪	---	○	---	
	周波数標準器	東 京	---	○	---	
		大 阪	---	○	---	
	周波数カウンタ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	周波数計	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	スペクトラムアナライザ	東 京	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	
	電界強度測定器、FFTアナライザ	東 京	---	○	A	
		愛 知	---	○	A	
		大 阪	---	○	A	

光

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
レーザビームパワー	光パワー測定器	東 京	405 nm帯 10 μW ～ 5 mW	405 nm帯 10 μW ～ 7 mW	---	
			488 nm帯 10 μW ～ 200 mW	488 nm帯 10 μW ～ 200 mW		
			515 nm帯 10 μW ～ 200 mW	515 nm帯 10 μW ～ 200 mW		
			633 nm帯 10 μW ～ 10 mW	633 nm帯 10 μW ～ 10 mW		
			660 nm帯 10 μW ～ 7 mW	660 nm帯 10 μW ～ 7 mW		
			780 nm帯 10 μW ～ 10 mW	780 nm帯 10 μW ～ 20 mW		
			850 nm帯 10 μW ～ 10 mW	850 nm帯, 1310 nm帯 10 μW ～ 10 mW		
			1047 nm帯 10 μW ～ 10 mW	1047 nm帯 10 μW ～ 20 mW		
			1064 nm帯 10 μW ～ 10 mW	1064 nm帯 10 μW ～ 20 mW		
			1310 nm帯 10 μW ～ 10 mW	1280 nm帯 ～ 1340 nm帯 10 μW～5 mW		
			1550 nm帯 10 μW ～ 5 mW	1520 nm帯 ～ 1630 nm帯 10 μW ～ 5 mW		
光ファイバパワー	光パワー測定器	東 京	850 nm帯 10 μW ～ 200 μW	850 nm帯 10 μW ～ 200 μW -20 dBm ～ -7 dBm	---	
			1280 nm帯 ～ 1340 nm帯 1 pW ～ 1 mW	1280 nm帯 ～ 1340 nm帯 10 μW ～ 10 mW -20 dBm ～ 10 dBm		
			1520 nm帯 ～ 1630 nm帯 1 pW ～ 10 mW	1520 nm帯 ～ 1630 nm帯 10 μW ～ 10 mW -20 dBm ～ 10 dBm		
			1310 nm帯, 1550 nm帯 1 pW ～ 10 mW	1310 nm帯, 1550 nm帯 1 nW ～ 10 mW -20 dBm ～ 10 dBm		
		大 阪	1310 nm帯, 1550 nm帯 10 μW ～ 500 μW	1310 nm帯, 1550 nm帯 10 nW ～ 500 μW	A	

※表のみかたはP02でご案内しています。

光

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
直線性	光パワー測定器(光電検出器)	東 京	1280 nm帯 ～ 1340 nm帯 −10 dB ～ −90 dB	1310 nm帯 −10 dB ～ −90 dB	---	・基準:0 dBm (1 mW) ・校正点:10 dB step
			1520 nm帯 ～ 1630 nm帯 −10 dB ～ −90 dB	1550 nm帯 −10 dB ～ −90 dB		
光減衰量	光減衰器	東 京	---	1280 nm帯 ～ 1340 nm帯 1 dB ～ 60 dB	---	
			---	1520 nm帯 ～ 1630 nm帯 1 dB ～ 60 dB		
波　長	光波長測定器、レーザ光源	東 京	---	633 nm, 1310 nm, 1550 nm	---	
距　離 (光ファイバ)	OTDR	大 阪	---	1310 nm帯 1500 m, 3000 m, 7500 m, 13000 m	A	
光　量	照度計	大 阪	---	1 lx ～ 10000 lx	---	A光源
			---	50 lx ～ 3000 lx	---	白色 LED(L41) 光源
	輝度計	大 阪	---	0.3 cd/m² ～ 3000 cd/m²	---	A 光源
	色度計(物体色)	大 阪	---	白色(A, C, D65光源)	A	色度座標(x, y)
	色度計(光源色)	大 阪	---	A光源	---	色度座標(x, y)
	光沢計	大 阪	---	0 GU ～ 2000 GU	A	
波　長	ネオジム光学フィルタ	東 京	---	Nominal@441 nm, 473 nm, 478 nm, 514 nm, 529 nm, 573 nm, 586 nm, 685 nm, 740 nm	---	JCRM001
	ホルミウム光学フィルタ	東 京	---	Nominal@279nm, 288nm, 334 nm, 361 nm, 386 nm, 419 nm, 446 nm, 454 nm, 460 nm, 536 nm	---	JCRM002
透過率	ND光学フィルタ	東 京	---	Nominal@1 %, 10 %, 20 %, 30 %, 40 %, 50 %	---	JCRM101, 110, 120, 130, 140, 150
	紫外域用光学フィルタ	東 京	---	Nominal@10 %, 30 %,50 %	---	JCRM210A, 230A, 250A
	近紫外域用光学フィルタ	東 京	---	Nominal@10 %, 30 %,50 %	---	JCRM310, 330, 350

回転速度

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
回転速度	接触式回転計	東 京	---	5 rpm ～ 15000 rpm	---	
		大 阪	---	40 rpm ～ 15000 rpm 0.6667 rps ～ 250 rps	---	
	接触式速度計	大 阪	---	1.3 m/min ～ 470 m/min 21 mm/sec ～ 7854 mm/sec	---	
	非接触式回転計(光)	東 京	---	0.5 rpm ～ 300000 rpm	A	
		愛 知	---	0.5 rpm ～ 600000 rpm	A	
		大 阪	---	6 rpm ～ 99990 rpm 0.1 rps ～ 1666.5 rps	---	
	ストロボスコープ	東 京	---	0.5 rpm ～ 300000 rpm	A	
		愛 知	---	0.5 rpm ～ 600000 rpm	A	
		大 阪	---	6 rpm ～ 99990 rpm	---	
	非接触式回転計(エンジン用回転)	大 阪	---	100 rpm ～ 9990 rpm	---	・センサと指示器セットで、イグニッションコイルの漏れ磁束を検出して回転数を校正

時　間

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
時　間	ストップウオッチ、時計	東 京	---	歩度:0 s/d ～ 388.8 s/d	---	
		愛 知	---	時間間隔測定:1 s ～ 18000 s	---	
		大 阪	---	歩度:0 s/d ～ 388.8 s/d	A	
		福 岡	---	歩度:0 s/d ～ 388.8 s/d	A	

EMC 機器

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
EMC	ダイポールアンテナ	東 京	---	30 MHz ～ 1 GHz	---	・基準アンテナ法 ・ANSI C63.5標準サイト法
	広帯域アンテナ (バイコニカル・アンテナ、ログペリオディック・アンテナ、バイログ・アンテナ)	東 京	---	30 MHz ～ 1 GHz	---	・基準アンテナ法 ・ANSI C63.5標準サイト法 ・SAE ARP958(バイログ・アンテナを除く) ・基準ダイポールアンテナとの置換
	ループアンテナ	大 阪	---	9 kHz ～ 30 MHz	---	・基準アンテナ法 ・CISPR16-1-6標準アンテナ法
	ホーンアンテナ	大 阪	---	1 GHz ～ 18 GHz	---	・ANSI C63.5標準サイト法 ・SAE ARP958
	モノポールアンテナ	大 阪	---	9 kHz ～ 30 MHz	A	・CISPR16-1-6
	EMIテストレシーバ (妨害波強度測定器)	大 阪	---	○	A	・正弦波レベル、Band Width、通過帯域特性、インパルス帯域幅、入力インパルス、パルス応答等
	擬似電源回路網(LISN/AMN/ISN)	大 阪	---	9 kHz ～ 230 MHz	A	・インピーダンス、電圧分配係数、アイソレーション等
	結合減結合回路網(CDN)	大 阪	---	150 kHz ～ 300 MHz	A	・インピーダンス
	パルス発生器	大 阪	---	○	A	・パルス波形(面積、パルス幅)、パルスレベル、繰り返し周波数、レベル平坦度等
	EFT/Burstシミュレータ	東 京	---	4 kV以下	A	・インパルス波形、バースト波形等
		大 阪	---	4 kV以下	A	
	ESDシミュレータ(静電気試験器)	大 阪	---	設定電圧30 kV以下	A	・出力電圧は25 kV以下
	ESDターゲット	大 阪	---	10 MHz ～ 4 GHz	---	・トランスファー・ファンクション:1 A
	サージ試験器	東 京	---	○	A	・ピーク電圧 ±(0.5 kV ～ 7 kV) ・ピーク電流 ±(12.5 A ～ 3.5 kA)
		大 阪	---	○	A	
	電圧ディップシミュレータ	大 阪	---	230 V以下	A	・出力電圧、立上り/立下り時間、位相等
	高周波電流プローブ	大 阪	---	10 kHz ～ 1 GHz	A	・ISO11452-4 ・CISPR16-1-2 ・挿入損失、トランスファーインピーダンス等
	磁界測定器	東 京	---	1 mT ～ 2 T	---	・DC
			---	1 μT, 10 μT, 100 μT	---	・50 Hz / 60 Hz

温　度

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
温　度	ガラス製温度計	東 京	0 ℃ ～ 50 ℃	−50 ℃ ～ 300 ℃*	---	*浸没線付きの校正が可能
		愛 知	−100 ℃ ～ 350 ℃	−80 ℃ ～ 350 ℃*	---	
		大 阪	−50 ℃ ～ 300 ℃*	−80 ℃ ～ 300 ℃*	---	
		福 岡	−50 ℃ ～ 300 ℃*	−50 ℃ ～ 300 ℃*	---	
	デジタル温度計	東 京	−40 ℃ ～ 300 ℃	−195.8 ℃, −100 ℃ ～ 1200 ℃	A	・出張範囲 東京：−100 ℃ ～ 950 ℃ 愛知：−100 ℃ ～ 700 ℃
		愛 知	−100 ℃ ～ 1544 ℃	−100 ℃ ～ 1554 ℃	A	
		大 阪	−80 ℃ ～ 420 ℃	−90 ℃ ～ 1000 ℃	---	
		福 岡	−50 ℃ ～ 300 ℃	−50 ℃ ～ 300 ℃	---	
	デジタル温度計(表面用センサ)	東 京	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
		愛 知	---	−100 ℃ ～ 500 ℃	---	
		大 阪	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
		福 岡	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
	機械式温度計	東 京	---	−50 ℃ ～ 300 ℃	---	
		愛 知	---	0 ℃ ～ 300 ℃	---	
		大 阪	---	−80 ℃ ～ 700 ℃	---	
		福 岡	---	−50 ℃ ～ 300 ℃	---	
	白金抵抗温度計	東 京	---	0 ℃ ～ 100 ℃	---	・2線式は校正不可
		愛 知	−100 ℃ ～ 420 ℃	−100 ℃ ～ 500 ℃	---	
	熱電対(Type E)	東 京	---	−195.8 ℃, −50 ℃ ～ 1000 ℃	---	
		愛 知	−100 ℃ ～ 1000 ℃	−100 ℃ ～ 1000 ℃	---	
		大 阪	−80 ℃ ～ 420 ℃	−80 ℃ ～ 1000 ℃	---	
	熱電対(Type J)	東 京	---	−195.8 ℃, −50 ℃ ～ 1200 ℃	---	
		愛 知	−100 ℃ ～ 1200 ℃	−100 ℃ ～ 1200 ℃	---	
		大 阪	−80 ℃ ～ 420 ℃	−80 ℃ ～ 1000 ℃	---	
	熱電対(Type K)	東 京	---	−195.8 ℃, −50 ℃ ～ 1200 ℃	---	
		愛 知	−100 ℃ ～ 1372 ℃	−100 ℃ ～ 1372 ℃	---	
		大 阪	−80 ℃ ～ 420 ℃	−80 ℃ ～ 1000 ℃	---	
	熱電対(Type N)	東 京	---	−195.8 ℃, −50 ℃ ～ 1200 ℃	---	
		愛 知	−100 ℃ ～ 1300 ℃	−100 ℃ ～ 1300 ℃	---	
	熱電対(Type R)	東 京	---	−50 ℃ ～ 1200 ℃	---	
		愛 知	−50 ℃ ～ 1554 ℃	−50 ℃ ～ 1554 ℃	---	
		大 阪	---	−50 ℃ ～ 1000 ℃	---	
	熱電対(Type S)	愛 知	−50 ℃ ～ 1554 ℃	−50 ℃ ～ 1554 ℃	---	
	熱電対(Type T)	東 京	---	−195.8 ℃, −50 ℃ ～ 400 ℃	---	
		愛 知	−100 ℃ ～ 400 ℃	−100 ℃ ～ 400 ℃	---	
		大 阪	−80 ℃ ～ 400 ℃	−80 ℃ ～ 400 ℃	---	
	基準接点補償器	愛 知	---	0 ℃	---	
	放射温度計	東 京	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
		愛 知	---	−50 ℃ ～ 1000 ℃	---	
		大 阪	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
	赤外線サーモグラフィ	東 京	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
		愛 知	---	−40 ℃ ～ 500 ℃	---	
		大 阪	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
	黒体炉	東 京	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
		愛 知	---	−50 ℃ ～ 1000 ℃	---	
		大 阪	---	−50 ℃ ～ 500 ℃	---	
	温度計校正装置	愛 知	−100 ℃ ～ 250 ℃	−100 ℃ ～ 700 ℃	A	・出張範囲 −100 ℃ ～ 600 ℃
	恒温槽	東 京	---	−80 ℃ ～ 950 ℃	A	
		愛 知	---	−80 ℃ ～ 950 ℃	A	
		大 阪	---	−80 ℃ ～ 950 ℃	A	
		福 岡	---	−80 ℃ ～ 950 ℃	A	
	指示計器付温度計(恒温槽装備)	東 京	−40 ℃ ～ 300 ℃	---	J	・恒温槽の温度指示部と槽内の温度センサとを組み合わせた指示計器付温度計としての校正

湿　度

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
湿　度（絶対湿度）	熱伝導率式湿度計	東 京	2.4 g/㎥ ～ 82.8 g/㎥	---	---	
湿　度（相対湿度）	湿度計	東 京	5 % ～ 98 %	5 % ～ 98 %	---	・露点(霜点)に換算した範囲 東京・愛知: −30 ℃ ～ 85 ℃ 大阪: −20 ℃ ～ 85 ℃ 福岡: −10 ℃ ～ 85 ℃ ・湿潤空気の温度範囲 東京:5 ℃ ～ 95 ℃ 愛知:5 ℃ ～ 90 ℃ 大阪:10 ℃ ～ 85 ℃ 福岡:20 ℃ ～ 85 ℃
		愛 知	5 % ～ 95 %	5 % ～ 95 %	---	
		大 阪	---	10 % ～ 95 %	---	
		福 岡	---	30 % ～ 95 %	---	
	通風乾湿計	東 京	10 % ～ 98 %	10 % ～ 98 %	---	・湿潤空気の温度範囲 5 ℃ ～ 25 ℃
	自記温湿度記録計(毛髪式)	東 京	---	10 % ～ 98 %	---	・露点に換算した範囲 −10 ℃ ～ 50 ℃ ・湿潤空気の温度範囲 5 ℃ ～ 60 ℃
	湿度発生装置	東 京	5 % ～ 98 %	5 % ～ 98 %	J/A	・露点(霜点)に換算した範囲 A2LA −30 ℃ ～ 25 ℃ JCSS −10 ℃ ～ 50 ℃
	恒温恒湿槽	東 京	---	5 % ～ 98 %	A	・露点に換算した範囲 東京・愛知・大阪: −30 ℃ ～ 85 ℃ 九州:0 ℃ ～ 85 ℃
		愛 知	---	5 % ～ 98 %	A	
		大 阪	---	5 % ～ 98 %	A	
		福 岡	---	10 % ～ 98 %	A	
湿　度（露点）	露点計	東 京	−30 ℃ ～ 85 ℃	−30 ℃ ～ 85 ℃	---	
		愛 知	−30 ℃ ～ 85 ℃	−30 ℃ ～ 85 ℃	---	
	湿度発生装置	東 京	−30 ℃ ～ 50 ℃	−30 ℃ ～ 50 ℃	J/A	

質　量

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
質　量	分銅(サブミリグラム)	東 京	0.05 mg ～ 1 mg未満	0.05 mg ～ 1 mg未満	---	
	分銅(E1)	東 京	1 mg ～ 20 kg	1 mg ～ 20 kg	---	
	分銅(E2)	東 京	1 mg ～ 20 kg	1 mg ～ 20 kg	---	
	分銅(F1)	東 京	1 mg ～ 20 kg	1 mg ～ 20 kg	---	・愛知のみおもり(F1) 1 g ～60 kgも校正可
		愛 知	1 mg ～ 20 kg	---	---	
		大 阪	1 mg ～ 20 kg	---	---	
		福 岡	1 mg ～ 20 kg	---	---	
	分銅(F2、M1 ～ M3)、おもり	東 京	1 mg ～ 50 kg	1 mg ～ 50 kg	A	・出張範囲 100 g ～ 50 kg(不確かさは上限M1相当)
		愛 知	1 mg ～ 60 kg	---	---	
		大 阪	1 mg ～ 20 kg	---	---	
		福 岡	1 mg ～ 20 kg	---	---	
	電子式非自動はかり	東 京	1 mg ～ 600 kg	1 mg ～ 1500 kg	J/A	・600 kg以上は出張のみ対応 ・愛知:500 kg超は持ち込みのクレーンスケールのみ対応
		愛 知	1 mg ～ 500 kg	1 mg ～ 10 t	J/A	
		大 阪	1 mg ～ 350 kg	1 mg ～ 600 kg	J/A	
		福 岡	---	1 mg ～ 300 kg	A	
	機械式非自動はかり	東 京	---	1 mg ～ 1500 kg	A	・600 kg以上は出張のみ対応
		愛 知	1 mg ～ 500 kg	1 mg ～ 500 kg	J/A	
		大 阪	1 g ～ 350 kg	1 mg ～ 600 kg	J/A	
		福 岡	---	1 mg ～ 300 kg	A	

力

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
力	ループ、ロードセル、その他力計（JIS B 7728による校正）	東 京	---	圧縮：10 mN ～ 1 kN 引張：10 mN ～ 1 kN	---	・東京：ロードセルのみ校正可能で、10 N未満を校正点に含む
		愛 知	圧縮：10 N ～ 3 MN 引張：10 N ～ 300 kN	圧縮：0.1 N ～ 3 MN 引張：0.1 N ～ 300 kN	---	
	ループ、ロードセル、その他力計（JIS B 7721に準じる校正）	愛 知	圧縮：1 N ～ 3 MN 引張：1 N ～ 300 kN	圧縮：0.1 N ～ 3 MN 引張：0.1 N ～ 300 kN	---	
	ループ、ロードセル、その他力計（JIS B 7602による校正）	愛 知	---	圧縮：0.1 N ～ 3 MN 引張：0.1 N ～ 300 kN	---	
	ループ、ロードセル、その他力計（ASTM E74による校正）	愛 知	圧縮：10 N ～ 3 MN 引張：10 N ～ 300 kN	圧縮：0.1 N ～ 3 MN 引張：0.1 N ～ 300 kN	---	
一軸試験機	一軸試験機（JIS B 7721による校正）	東 京	圧縮：0.1 N ～ 5 MN 引張：0.1 N ～ 100 kN	圧縮：0.01 N ～ 3 MN 引張：0.01 N ～ 100 kN	J/A	
		大 阪	圧縮：0.1 N ～ 3000 kN 引張：0.1 N ～ 300 kN	圧縮：0.1 N ～ 3 MN 引張：0.1 N ～ 300 kN	J/A	
		福 岡	圧縮：10 N ～ 5 MN 引張：0.1 N ～ 300 kN	圧縮：0.1 N ～ 5 MN 引張：0.1 N ～ 100 kN	J/A	
	一軸試験機（ASTM E4による校正）	東 京	圧縮：0.1 N ～ 2000 kN 引張：0.1 N ～ 100 kN	圧縮：0.01 N ～ 3 MN 引張：0.01 N ～ 100 kN	J/A	
		大 阪	---	圧縮:0.1 N ～ 3 MN 引張:0.1 N ～ 300 kN	A	
		福 岡	---	圧縮：10 N ～ 2 MN	A	
	試験機クロスヘッド	東 京	---	速度：0.5 mm/min ～ 1000 mm/min 距離：0.5 mm ～ 600 mm	A	
		大 阪	---	速度：0.5 mm/min ～ 1000 mm/min 距離:0.1 mm ～ 600 mm	A	
	（伸び計）	p07の【一軸試験機・硬さ関連機器】を参照				
力計測器	プッシュプル、フォースゲージ	東 京	---	圧縮：10 mN ～ 5 kN 引張：10 mN ～ 5 kN	A	・出張範囲 東京・大阪:500 N以下
		愛 知	---	圧縮：0.1 N ～ 5 kN 引張：0.1 N ～ 5 kN	---	
		大 阪	---	圧縮：10 mN ～ 50 kN 引張：10 mN ～ 5 kN	A	
		福 岡	---	圧縮:100 mN ～ 0.5 kN 引張:100 mN ～ 0.5 kN	---	
	ダイヤルテンションゲージ	東 京	---	10 mN ～ 20 N	A	
		大 阪	---	10 mN ～ 20 N	---	
	テンションゲージ、コンプレッションゲージ	東 京	---	圧縮：10 mN ～ 1 kN 引張：10 mN ～ 1 kN	A	・出張範囲 東京:500 N以下 大阪:300 N以下
		愛 知	---	圧縮：0.1 N ～ 300 N 引張：0.1 N ～ 300 N	---	
		大 阪	---	圧縮：10 mN ～ 500 N 引張：10 mN ～ 2 kN	A	
		福 岡	---	圧縮:100 mN ～ 0.5 kN 引張:100 mN ～ 0.5 kN	---	
張力計	ワイヤテンションメータ	東 京	---	0.1 N ～ 500 N	---	
		愛 知	---	0.1 N ～ 500 N	---	

トルク

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
トルク	参照用トルクレンチ	愛 知	5 N･m ～ 1 kN･m	---	---	
	トルクメータ(JMIF015, DIN 51309)	愛 知	0.01 N･m ～ 10 kN･m	0.01 N･m ～ 10 kN･m	---	
	トルク計測器（トルクレンチテスタ）	東 京	---	25 mN･m ～ 1 kN･m	A	
		愛 知	5 N･m ～ 1 kN･m	5 N･m ～ 1 kN･m	A	
		大 阪	---	0.4 N･m ～ 2 kN･m	A	
	トルク計測器（トルクテスタ等）	東 京	---	1 mN･m ～ 1 kN･m	A	・東京は500 N･mを超える場合は要相談 ・出張範囲 東京・大阪:20 N･m以下
		愛 知	0.1 N･m ～ 10 N･m	20 mN･m ～ 1 kN･m	---	
		大 阪	---	10 mN･m ～ 1 kN･m	A	
	手動式トルクツール	東 京	---	20 mN･m ～ 1 kN･m	A	・出張範囲 東京:300 N･m以下 大阪:200 N･m以下 愛知:200 N･m以下
		愛 知	5 N･m ～ 1 kN･m	20 mN･m ～ 1 kN･m	A	
		大 阪	---	20 mN･m ～ 2 kN･m	A	
		福 岡	---	200 mN･m ～ 500 N･m	A	

硬　さ

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
硬　さ	ロックウェル硬さ試験機（JIS B 7726による校正）	東 京	C	A, B, C, 15N, 15T, 30N, 30T	J/A	・硬さ範囲は規格の各レベルで実施
		大 阪	---	A, B, C, E, 15N, 15T, 30N, 30T	A	
		福 岡	---	B, C	A	
	ロックウェル硬さ試験機（ASTM E 18による校正）	東 京	---	A, B, C, 15N, 15T, 30N, 30T	A	・硬さ範囲は規格の各レベルで実施 ・認定校正済みの圧子をご用意ください
		大 阪	---	A, B, C, E, 15N, 15T, 15Y, 30N, 30T	A	
		福 岡	---	B, C	A	
	ビッカース硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機（JIS B 7725による校正）	東 京	○	○	J/A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施 ・実施荷重については要お問い合わせ
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	ビッカース硬さ試験機、マイクロビッカース硬さ試験機（ASTM E 92による校正）	東 京	---	○	A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施 ・実施荷重については要お問い合わせ ・認定校正済みの圧子をご用意ください
		大 阪	---	○	A	
		福 岡	---	○	A	
	ブリネル硬さ試験機（JIS B 7724による校正）	東 京	10/3000, 5/750, 10/500, 10/1000	10/3000, 5/750, 10/500, 10/1000, 2.5/62.5, 2.5/187.5, 1/30	J/A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施 ・500 kg未満の校正については要お問い合わせ
		大 阪	---	10/3000, 10/1000, 10/500, 5/750, 2.5/187.5, 2.5/62.5, 1/30, 1/10	A	
		福 岡	---	10/3000, 5/750	A	
	ブリネル硬さ試験機（ASTM E 10による校正）	東 京	---	10/3000, 5/750, 10/500, 2.5/62.5, 2.5/187.5, 1/30	A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施 ・認定校正済みの圧子をご用意ください ・500 kg未満の校正については要お問い合わせ
		大 阪	---	10/3000, 10/1000, 10/500, 5/750, 2.5/187.5, 2.5/62.5, 1/30, 1/10	A	
		福 岡	---	10/3000, 5/750	A	
	ブリネル硬さ試験機（ASTM E 110による校正）	東 京	---	10/3000, 5/750, 10/500, 2.5/62.5, 2.5/187.5, 1/30	A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施 ・認定校正済みの圧子をご用意ください ・500 kg未満の校正については要お問い合わせ

硬　さ

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
硬　さ	ショア硬さ試験機（JIS B 7727による校正）	東 京	---	○	A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施
		大 阪	---	○	A	
	ヌープ硬さ試験機（ISO 4545-2, (JIS B 7734)による校正）	東 京	---	○	A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施
		大 阪	---	○	A	
	ヌープ硬さ試験機（ASTM E 92による校正）	東 京	---	○	A	・硬さ範囲は規格の要求事項に合わせ実施 ・認定校正済みの圧子をご用意ください ・実施荷重については要お問い合わせ
		大 阪	---	○	A	
	リーブ硬さ試験機（ASTM A956/A956Mによる校正）	東 京	---	○	A	・JQA任意の硬さ範囲で実施
		大 阪	---	○	A	
	UCI硬さ試験機（ASTM A 1038による校正）	東 京	---	HV（UCI), HRC（UCI), HBW（UCI）	A	・JQA任意の硬さ範囲で実施
	ロックウェルダイヤモンド圧子（JIS B 7726, ISO 6508-2, ASTM E18 による校正）	東 京	---	複合スケール(A,C,D 及び N スケール)	---	ASTM E18による校正はClass Bのみ対応
	ロックウェルボール圧子（JIS B 7726, ISO 6508-2 による校正）	東 京	---	1.588 mm（1/16 inch） 3.175 mm（1/8 inch）	---	
	ロックウェルボール圧子（ASTM E18 による校正）	東 京	---	1.588 mm（1/16 inch） 3.175 mm（1/8 inch） 6.350 mm（1/4 inch） 12.70 mm（1/2 inch）	---	Class Bのみ対応
	ロックウェル硬さ標準片（JIS B 7726, ISO 6508-3 による校正）	東 京	---	(A,C,D,15N,30N,45N,BW,FW,GW,EW,HW,KW,15TW,30TW,45TW)	---	
	ロックウェル硬さ標準片（ASTM E18 による校正）	東 京	---	(A,C,D,15N,30N,45N,BW,FW,GW,EW,HW,KW,15TW,30TW,45TW,LW,MW,PW,RW,SW,VW,15WW,30WW,45WW,15XW.30XW,45XW,15YW,30YW,45YW)	---	
	デュロメータ（ASTM D 2240, JIS K 6253-5, JIS K 7215, JIS K 7312, JIS K 6301による校正）	東 京	---	○	---	・デュロメータの形状によっては実施不可 ・各規格のタイプによっては実施不可
	デュロメータ荷重検査器	東 京	---	○	---	

圧　力

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
圧　力	重錘形圧力天びん(気体･ゲージ圧力)	愛 知	18 kPa ～ 5 MPa	8 kPa ～ 5 MPa	---	・出張校正はデジタル圧力計を標準器とした校正
		福 岡	---	0 kPa ～ 7 MPa	A	
	重錘形圧力天びん(気体･絶対圧力)	愛 知	18 kPa ～ 350 kPa	8 kPa ～ 350 kPa	---	
	重錘形圧力天びん(液体･ゲージ圧力)	愛 知	1 MPa ～ 100 MPa	0.1 MPa ～ 100 MPa	---	・出張校正はデジタル圧力計を標準器とした校正
		大 阪	1 MPa ～ 100 MPa	0.5 MPa ～ 100 MPa	---	
		福 岡	---	0 MPa ～ 100 MPa	A	
	液柱形圧力計(水銀柱式･ゲージ圧力)	愛 知	13 kPa ～ 220 kPa	0 kPa ～ 220 kPa	---	
		大 阪	20 kPa ～ 200 kPa	---	---	
		福 岡	---	0 kPa ～ 220 kPa	A	
	液柱形圧力計(水柱式･ゲージ圧力)	愛 知	2 kPa ～ 20 kPa	0 kPa ～ 20 kPa	---	
		福 岡	---	0 kPa ～ 20 kPa	A	
	デジタル圧力計(気体･ゲージ圧力)	東 京	---	−95 kPa ～ 5 MPa	A	
		愛 知	−100 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 5 MPa	−100 kPa ～ 5 MPa	A	
		大 阪	−100 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 3.5 MPa	−100 kPa ～ 3.5 MPa	---	
		福 岡	---	−95 kPa ～ 7 MPa	A	

圧　力

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
圧　力	デジタル圧力計(気体･絶対圧力)	東 京	---	8 kPa ～ 5 MPa	---	
		愛 知	18 kPa ～ 5.1 MPa	8 kPa ～ 5.1 MPa	---	
		大 阪	18 kPa ～ 350 kPa	8 kPa ～ 350 kPa	---	
	デジタル圧力計(気体･差圧)	東 京	---	−20 kPa ～ 20 kPa	A	
		愛 知	−20 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 20 kPa	−20 kPa ～ 20 kPa	A	
		大 阪	−20 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 20 kPa	−20 kPa ～ 20 kPa	---	
	デジタル圧力計(液体･ゲージ圧力)	東 京	---	0 MPa ～ 100 MPa	A	
		愛 知	1 MPa ～ 100 MPa	0.1 MPa ～ 100 MPa	---	
		大 阪	1 MPa ～ 100 MPa	0.1 MPa ～ 250 MPa	---	
		福 岡	---	0 MPa ～ 100 MPa	A	
	デジタル圧力計(液体･絶対圧力)	愛 知	1.1 MPa ～ 100.1 MPa	0.2 MPa ～ 100.1 MPa	---	
	圧力センサ(気体･ゲージ圧力)	東 京	---	−95 kPa ～ 5 MPa	---	
		愛 知	−100 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 5 MPa	−100 kPa ～ 5 MPa	---	
		大 阪	---	−100 kPa ～ 3.5 MPa	---	
		福 岡	---	−95 kPa ～ 7 MPa	---	
	圧力センサ(気体･絶対圧力)	東 京	---	8 kPa ～ 5 MPa	---	
		愛 知	18 kPa ～ 5.1 MPa	8 kPa ～ 5.1 MPa	---	
		大 阪	---	8 kPa ～ 350 kPa	---	
	圧力センサ(気体･差圧)	東 京	---	−20 kPa ～ 20 kPa	---	
		愛 知	−20 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 20 kPa	−20 kPa ～ 20 kPa	---	
		大 阪	---	−20 kPa ～ 20 kPa	---	
	圧力センサ(液体･ゲージ圧力)	東 京	---	0 MPa ～ 100 MPa	---	
		愛 知	1 MPa ～ 100 MPa	0.1 MPa ～ 100 MPa	---	
		大 阪	---	0.1 MPa ～ 100 MPa	---	
		福 岡	---	0 MPa ～ 100 MPa	---	
	圧力センサ(液体･絶対圧力)	愛 知	1.1 MPa ～ 100.1 MPa	0.2 MPa ～ 100.1 MPa	---	
	機械式圧力計(気体･ゲージ圧力)	東 京	---	−95 kPa ～ 5 MPa	A	
		愛 知	−100 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 5 MPa	−100 kPa ～ 5 MPa	A	
		大 阪	−100 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 3.5 MPa	−100 kPa ～ 3.5 MPa	---	
		福 岡	---	−95 kPa ～ 7 MPa	A	
	機械式圧力計(気体･絶対圧力)	東 京	---	8 kPa ～ 5 MPa	---	
		愛 知	18 kPa ～ 5.1 MPa	8 kPa ～ 5.1 MPa	---	
		大 阪	---	8 kPa ～ 350 kPa	---	
	機械式圧力計(気体･差圧)	東 京	---	−20 kPa ～ 20 kPa	A	
		愛 知	−20 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 20 kPa	−20 kPa ～ 20 kPa	A	
		大 阪	−20 kPa ～ −0.005 kPa 0.005 kPa ～ 20 kPa	−20 kPa ～ 20 kPa	---	
	機械式圧力計(液体･ゲージ圧力)	東 京	---	0 MPa ～ 100 MPa	A	
		愛 知	1 MPa ～ 100 MPa	0.1 MPa ～ 100 MPa	---	
		大 阪	1 MPa ～ 100 MPa	0.1 MPa ～ 250 MPa	---	
		福 岡	---	0 MPa ～ 100 MPa	A	

圧　力

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
圧　力	機械式圧力計（液体・絶対圧力）	愛 知	1.1 MPa ～ 100.1 MPa	0.2 MPa ～ 100.1 MPa	---	
	配管のできない気圧計（気体・絶対圧力）	東 京	---	75 kPa ～ 110 kPa	---	・フォルタン水銀気圧計は除く
		愛 知	75 kPa ～ 115 kPa	75 kPa ～ 115 kPa	---	
		大 阪	---	75 kPa ～ 110 kPa	---	
		福 岡	---	75 kPa ～ 115 kPa	---	
	真空計	愛 知	0.001 Pa ～ 101 kPa	---	---	・液柱差真空計、マクラウド真空計は除く
	標準リーク	愛 知	3.3×10^{-7} Pa·m³/s ～ 1.7×10^{-4} Pa·m³/s	---	---	・気体種：窒素、ヘリウム、R-134a、R-410A ・流出先の圧力：大気圧

流速・流量

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
気体流速	風速計	東 京	0.05 m/s ～ 40 m/s	---	---	
気体流量	流量計	東 京	---	流量： 1 mL/min ～ 60 L/min 流量制御： 1 mL/min ～ 60 L/min	---	・流体：空気

音響・振動

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
音　響	計測用マイクロホン（Ⅰ形）	東 京	20 Hz ～ 12.5 kHz	20 Hz ～ 12.5 kHz	---	
	計測用マイクロホン（Ⅱ形）	東 京	20 Hz ～ 20 kHz	20 Hz ～ 20 kHz	---	
	サウンドレベルメータ	東 京	自由音場レスポンスレベル： 20 Hz ～ 20 kHz	自由音場レスポンスレベル： 10 Hz ～ 20 kHz 目盛標識： 31.5 Hz ～ 12.5 kHz レベルレンジ切換器： 31.5 Hz ～ 12.5 kHz レベル直線性： 31.5 Hz ～ 12.5 kHz	---	
		愛 知	自由音場レスポンスレベル： 125 Hz ～ 8 kHz	---	---	
		大 阪	自由音場レスポンスレベル： 20 Hz ～ 12.5 kHz	自由音場レスポンスレベル： 20 Hz ～ 12.5 kHz 目盛標識： 31.5 Hz ～ 8 kHz レベルレンジ切換器： 31.5 Hz ～ 8 kHz レベル直線性： 31.5 Hz ～ 8 kHz	---	
		福 岡	自由音場レスポンスレベル： 125 Hz ～ 8 kHz	---	---	
	サウンドレベルメータ （IEC 61672-3:2013による定期試験）	東 京	---	○	---	
	音響校正器	東 京	音圧レベル： 31.5 Hz ～ 16 kHz	音圧レベル： 31.5 Hz ～ 16 kHz 周波数：250 Hz , 1 kHz ひずみ率：250 Hz , 1 kHz	J	・出張校正は巡回検定時のみ対応 ・出張校正は音圧レベル（250 Hz,1 kHz）のみ対応
		愛 知	音圧レベル： 250 Hz, 1 kHz	---	J	

※表のみかたはP02でご案内しています。

音響・振動

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
音　響	音響校正器	大 阪	音圧レベル： 250 Hz, 1 kHz	---	J	・出張は巡回検定時のみ対応 ・出張は音圧レベル（250 Hz,1 kHz）のみ対応
		福 岡	音圧レベル： 250 Hz, 1 kHz	---	J	
	オージオメータ	東 京	125 Hz ～ 8 kHz	---	---	
		愛 知	125 Hz ～ 8 kHz	---	---	
		大 阪	125 Hz ～ 8 kHz	---	---	
		福 岡	125 Hz ～ 8 kHz	---	---	
	基準音源	東 京	---	1/3オクターブバンド 音響パワーレベル （50 Hz ～ 20 kHz）及び 音響パワーレベル	---	
	ハイドロホン	東 京	---	0.5 MHz ～ 20 MHz	---	
振動加速度	振動加速度計（振動ピックアップ）	東 京	0.5 Hz ～ 10 kHz	0.5 Hz ～ 10 kHz	---	
		愛 知	---	10 Hz ～ 10 kHz	---	
		大 阪	---	5 Hz ～ 10 kHz	---	
		福 岡	---	20 Hz ～ 5 kHz	---	
	振動計	東 京	---	5 Hz ～ 10 kHz	---	・東京及び大阪の振動レベル計は 4 Hz～31.5 Hz ・愛知の振動レベル計は 4 Hz～80 Hz
		愛 知	---	4 Hz ～ 10 kHz	---	
		大 阪	---	5 Hz ～ 10 kHz	---	
		福 岡	---	5 Hz ～ 2 kHz	---	
	振動試験機（加振機）	東 京	---	5 Hz ～ 5 kHz	A	
		愛 知	---	5 Hz ～ 5 kHz	A	
		大 阪	---	5 Hz ～ 5 kHz	A	
		福 岡	---	5 Hz ～ 5 kHz	A	
	チャージアンプ、チャージコンバータ	東 京	---	20 Hz ～ 10 kHz	---	
		大 阪	---	20 Hz ～ 10 kHz	---	
	電圧増幅器	大 阪	---	10 Hz ～ 10 kHz	---	
	インパルスハンマ	東 京	---	1 N ～ 200 N	---	
	校正用加振器	東 京	---	4 Hz ～ 10 kHz	---	
		大 阪	---	20 Hz ～ 500 Hz	---	

濃　度

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
水素イオン濃度	ガラス電極式水素イオン濃度指示計	東 京	---	器差：4 pH及び9 pH 直線性：0 pH ～ 14 pH 繰り返し性：7 pH及び4 pH	---	
		愛 知	---	器差：4 pH及び9 pH 直線性：0 pH ～ 14 pH 繰り返し性：7 pH及び4 pH	A	
		大 阪	---	器差：4 pH及び9 pH 直線性：0 pH ～ 14 pH 繰り返し性：7 pH及び4 pH	---	
		福 岡	---	器差：4 pH及び9 pH 直線性：0 pH ～ 14 pH 繰り返し性：7 pH及び4 pH	A	
	ガラス電極式水素イオン濃度検出器	東 京	---	器差：4 pH及び9 pHの2点間における1 pHあたりの起電力 直線性：4 pH, 7 pH及び9 pHの3点間の直線性 繰り返し性：4 pH, 7 pH, 9 pH	---	
		愛 知	---	器差：4 pH及び9 pHの2点間における1 pHあたりの起電力 直線性：4 pH, 7 pH及び9 pHの3点間の直線性 繰り返し性：4 pH, 7 pH, 9 pH	A	

※表のみかたはP02でご案内しています。

濃　度

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
水素イオン濃度	ガラス電極式水素イオン濃度検出器	大 阪	---	器差:4 pH及び9 pHの2点間における1 pHあたりの起電力 直線性:4 pH, 7 pH及び9 pHの3点間の直線性 繰り返し性:4 pH, 7 pH, 9 pH	---	
		福 岡	---	器差:4 pH及び9 pHの2点間における1 pHあたりの起電力 直線性:4 pH, 7 pH及び9 pHの3点間の直線性 繰り返し性:4 pH, 7 pH, 9 pH	A	
	ガラス電極式水素イオン濃度計	東 京	---	器差:4 pH, 7 pH, 9 pH	---	
		愛 知	---	器差:4 pH, 7 pH, 9 pH	A	
		大 阪	---	器差:4 pH, 7 pH, 9 pH	---	
		福 岡	---	器差:4 pH, 7 pH, 9 pH	A	
電気伝導率	電気伝導率計	東 京	---	1.51 mS/m, 14.7 mS/m, 141 mS/m, 1280 mS/m	---	
		愛 知	---	14.7 mS/m, 141 mS/m, 1280 mS/m	---	
CO_2濃度	CO_2計	東 京	---	0 ppm, 400 ppm, 700 ppm, 1000 ppm, 2000 ppm, 4000 ppm, 5000 ppm, 8000 ppm, 10000 ppm	---	
		愛 知	---	0 ppm ～ 5000 ppm	---	
CO濃度	大気濃度計	福 岡	---	5 ppm ～ 50000 ppm	A	
NO_x濃度	大気濃度計	福 岡	---	25 ppm ～ 5000 ppm	A	
SO_2濃度	大気濃度計	福 岡	---	25 ppm ～ 5000 ppm	A	
O_2濃度	大気濃度計	福 岡	---	5 vol% ～ 25 vol%	A	

粘　度

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
粘　度	単一円筒形回転粘度計	東 京	---	JS 200(150±50 mPa·s) JS 500(350±100 mPa·s) JS 1000(700±200 mPa·s) JS 2000(1500±500 mPa·s) JS 14000(8000±3000 mPa·s) JS 52000(35±15 Pa·s)	---	

微粒子

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
粒子個数濃度	光散乱式気中粒子計数器 (パーティクルカウンタ)	東 京	---	計数効率: 粒径0.05 μm ～ 10.0 μm 空気流量: 0.1 L/min ～ 30 L/min	---	

熱　量

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS*	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
熱　量	熱量標準安息香酸	東 京	1 g当たりの発熱量	---	---	* 計量法に基づく指定校正機関として、指定範囲についてjcssシンボル付証明書を発行

密　度

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
浮ひょう	密度浮ひょう	愛 知	0.60 g/㎤ ～ 2.00 g/㎤	---	---	
	比重浮ひょう	愛 知	0.60 ～ 2.00	---	---	
	酒精度浮ひょう	愛 知	0 vol% ～ 100 vol%	---	---	
	日本酒度浮ひょう	愛 知	−40 日本酒度 ～ +30 日本酒度	---	---	
	重ボーメ度浮ひょう	愛 知	0 重ボーメ度 ～ 72 重ボーメ度	---	---	

体　積

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
体　積	ピストン式体積計	東 京	---	～ 100 mL*	---	*最大容量(呼び容量)が校正範囲内であるものに限る ・愛知はマイクロピペットのみ校正可能
		愛 知	1 μL ～ 10 mL*	---	---	
	全量ピペット	東 京	---	0.1 mL ～ 200 mL*	---	*最大容量(呼び容量)が校正範囲内であるものに限る
		愛 知	---	～ 200 mL*	---	
		大 阪	---	～ 200 mL*	---	
		福 岡	---	0.5 mL ～ 100 mL*	---	
	メスピペット	東 京	---	0.1 mL ～ 50 mL*	---	*最大容量(呼び容量)が校正範囲内であるものに限る
		愛 知	---	～ 50 mL*	---	
		大 阪	---	～ 50 mL*	---	
		福 岡	---	0.1 mL ～ 50 mL*	---	
	ビュレット	東 京	---	1 mL ～ 2000 mL*	---	*最大容量(呼び容量)が校正範囲内であるものに限る
		愛 知	---	～ 100 mL*	---	
		大 阪	---	～ 100 mL*	---	
		福 岡	---	1 mL ～ 100 mL*	---	
	全量フラスコ	東 京	---	～ 5000 mL*	---	*最大容量(呼び容量)が校正範囲内であるものに限る
		愛 知	---	～ 10000 mL*	---	
		大 阪	---	～ 5000 mL*	---	
		福 岡	---	5 mL ～ 2000 mL*	---	
	メスシリンダー	東 京	---	～ 5000 mL*	---	*最大容量(呼び容量)が校正範囲内であるものに限る
		愛 知	---	～ 2000 mL*	---	
		大 阪	---	～ 2000 mL*	---	
		福 岡	---	～ 2000 mL*	---	

衝突エネルギー

量	品目	実施事業所	校正範囲 JCSS	校正範囲 A2LA	出張校正	備考
衝突エネルギー	スプリングハンマ	東 京	---	0.2 J ～ 1.0 J	---	
		大 阪	---	0.2 J ～ 1.0 J	---	

その他、表にない計測器や特殊な計測器でも、認定校正または一般校正が可能な場合もございます。
裏表紙に記載の最寄りの「お問い合わせ先」までご相談ください。

お問い合わせ先

■計量計測センター

〒192-0364 東京都八王子市南大沢4-4-4
TEL. 042-679-0144（営業課）
E-mail: jtp-calib-cstm@jqa.jp

■計量計測センター 福島営業所

〒963-8001 福島県郡山市大町2-12-13　宝栄郡山ビル701
TEL. 024-927-5450
E-mail: fuku-calib-cstm@jqa.jp

■中部試験センター

〒481-0043 愛知県北名古屋市沖村五反22
TEL. 0568-24-5111（営業課）
E-mail: chubu-cstm@jqa.jp

■関西試験センター 広島営業所

〒730-0041 広島県広島市中区小町3-25　三共広島ビル8階
TEL. 082-236-7209
E-mail: hiroshima-cstm@jqa.jp

■関西試験センター

〒578-0921 大阪府東大阪市水走3-8-19
TEL. 072-966-7209（営業課）
E-mail: kansai-cstm@jqa.jp

■九州試験所

〒839-0801 福岡県久留米市宮ノ陣3-2-33
TEL. 0942-48-7763
E-mail: kyushu-cstm@jqa.jp

一般財団法人 日本品質保証機構

https://www.jqa.jp

ミックス 紙 | 責任ある森林管理を支えています FSC® C009249

Carbon Offset for 233 g CO2/cap Printing. Naturally.

non VOC ink

Green Power

26.08 C3002003